



CARTA DE TRAZABILIDAD


Area: DIMENSIONAL

2024-07-29

CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2

Laboratorio
Primario

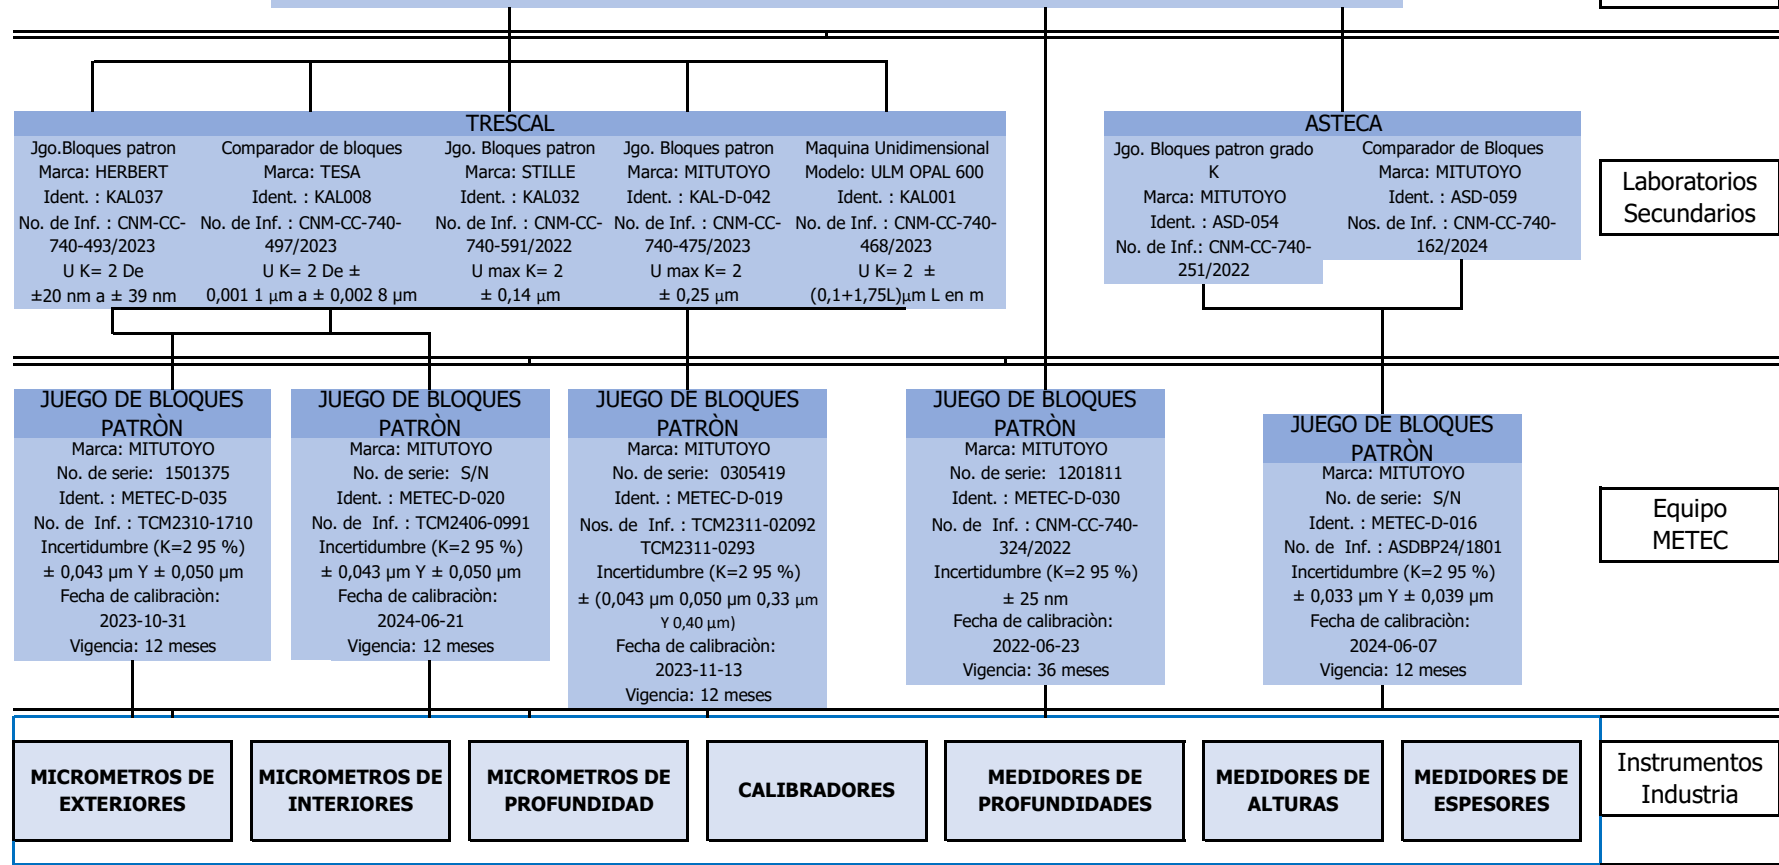

NOTAS:

FTO-AT-08



CARTA DE TRAZABILIDAD


Area: DIMENSIONAL

2024-06-10

CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2

Laboratorio
Primario

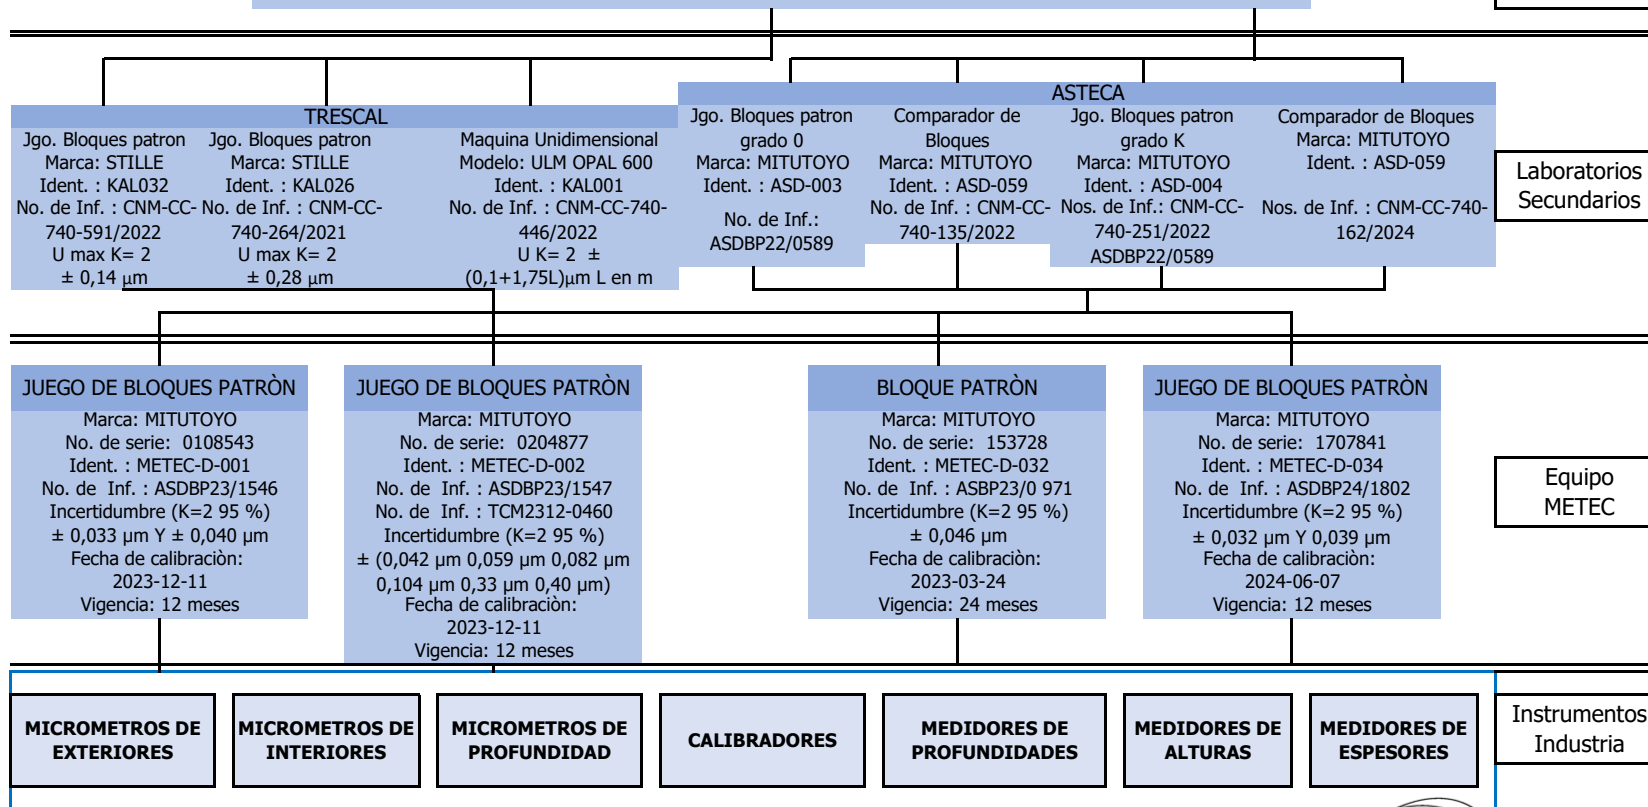

NOTAS:

FTO-AT-08



CARTA DE TRAZABILIDAD


Area: DIMENSIONAL

2024-10-28

CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2

Laboratorio
Primario

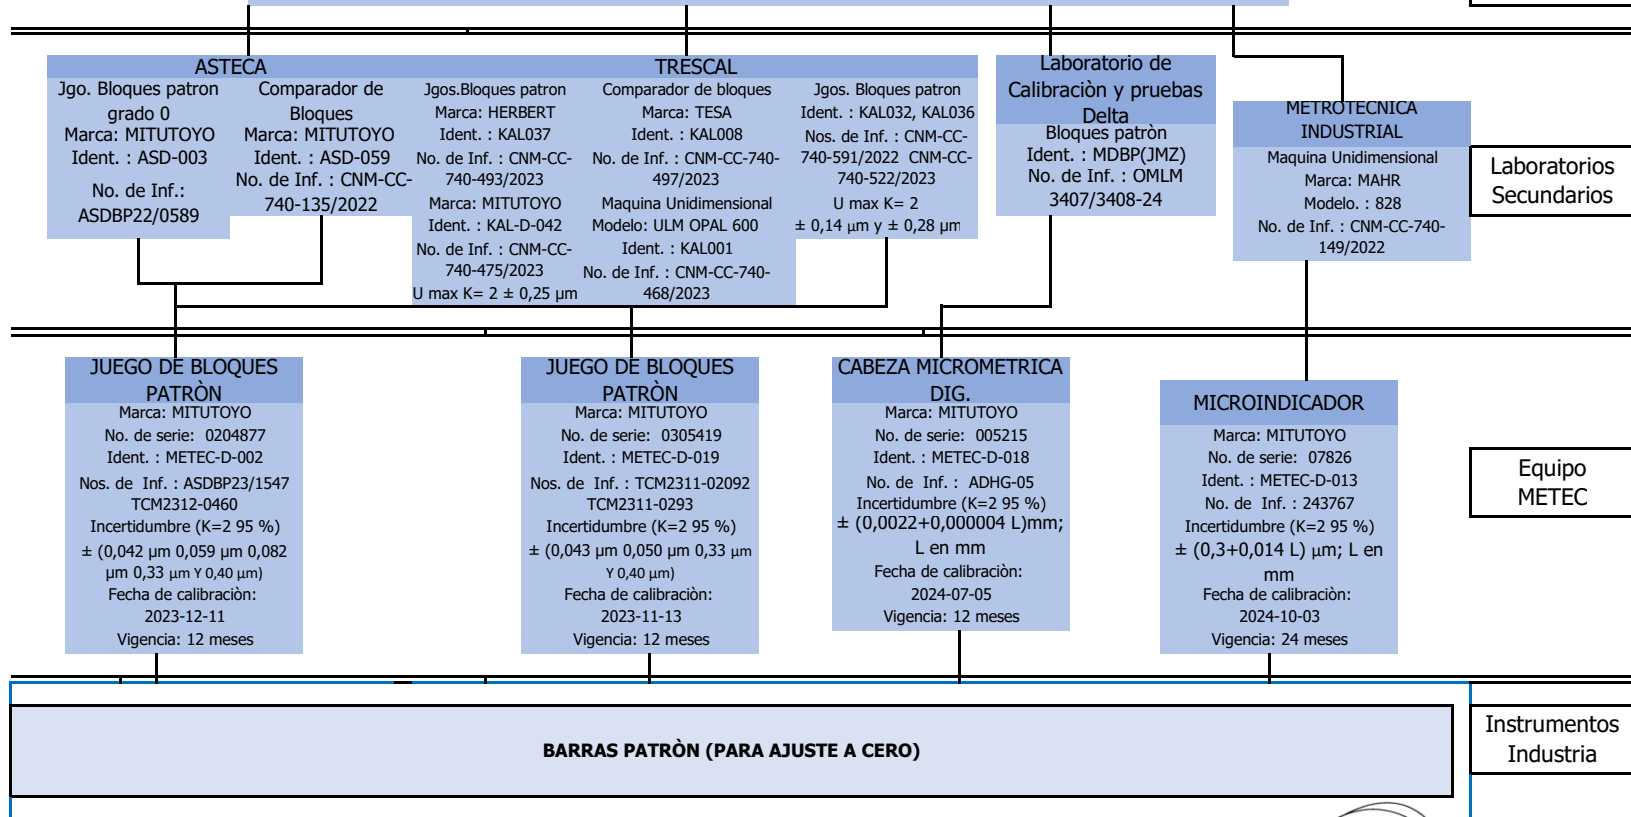

Laboratorios
Secundarios

Equipo
METEC

Instrumentos
Industria

NOTAS:

FTO-AT-08




CARTA DE TRAZABILIDAD

Area: DIMENSIONAL
2024-07-29

CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2

Laboratorio
Primario

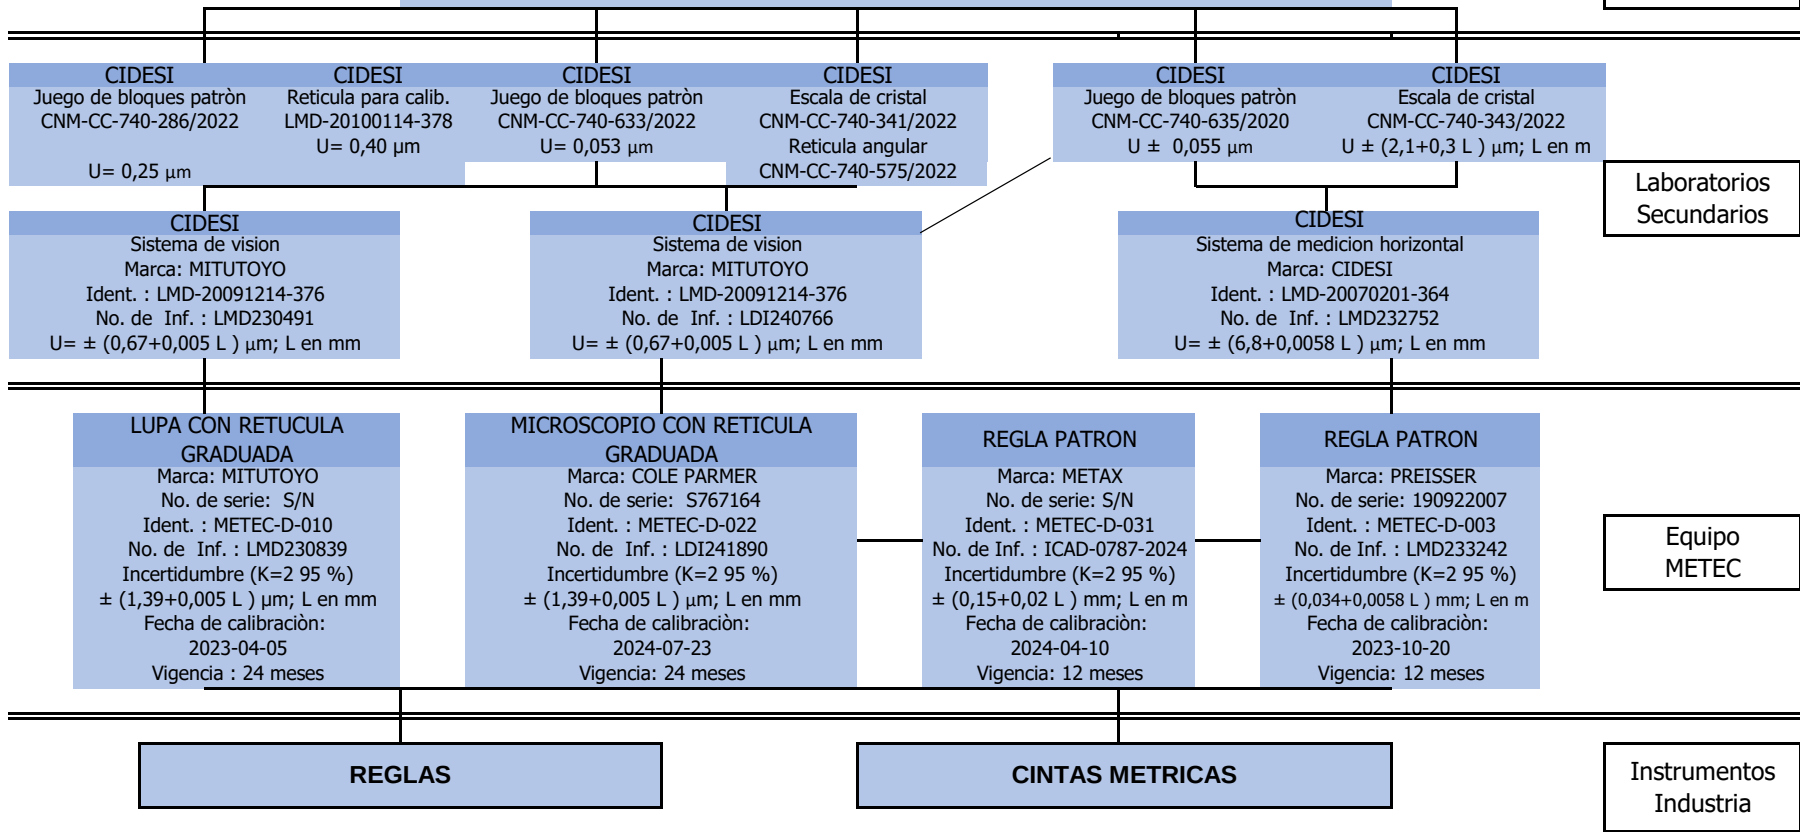

Laboratorios
Secundarios

Equipo
METEC

Instrumentos
Industria

NOTAS:

FTO-AT-08



Area: DIMENSIONAL
2025-01-17

CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2

Laboratorio
Primario

MITUTOYO

Comparador de bloques, 0014303
LNAUC-002, 1813677
Juegos de bloques Patròn grado K

ASMET

Comparador de bloques
CNM-CC-740-182/2019
de bloques patron K, 0 Y 1

OMSA

Bloques patròn
CNM-CC-740-055/2023

Laboratorios Secundarios

TecNovaMet

Bloques patron
Marca: MITUTOYO
Ident. : T-029
No. de Inf. : 2306
U=

TecnovaMet

Bloques patron
 Marca: MITUTOYO
 Ident. : T-144 a T-146
 No. de Inf. : 240957;
 240959

TecNovaMet

Bloques patron
 Marca: MITUTOYO
 Ident. : T-017
 de Inf. : G3DB184-01
 U=

TecNovaMet

Palpador electronico
 Marca: MAHR FEDERAL
 Ident. : T-075
 e Inf. : CNM-CC-740-292/2024
 U= 0,5 μ m

Laboratorio de Calibración y pruebas Delta

Bloques patròn
Ident. : MDBP(JMZ)
No. de Inf. : OMLM 3407/3408-24

CALIBRADOR DE

Marca: MITUTOYO

No. de serie: 200236
Ident. : METEC-D-004
No. de Inf. : D-0042-25
Incertidumbre (K=2 95%)
 $\pm (0,63+0,38 \text{ L}) \mu\text{m}$; L en m
Fecha de calibraci3n:
2025-01-17
Vigencia: 12 meses

CABEZA MICROMETRICA

DIG.

Marca: MITUTOYO
 No. de serie: 005215
 Ident. : METEC-D-018
 No. de Inf. : ADHG-05
 Incertidumbre (K=2 95%)
 $\pm (0,0022+0,000004 L)\text{mm}$;
 Fecha de calibración:
 2024-07-05
 Vigencia: 12 meses

Equipo
METEC

INDICADORES DE VASTAGO RECTO

INDICADORES DE CARATULA TIPO PALANCA

Instrumentos Industria

NOTAS:

FTO-AT-08

